nexis®
Cannulated Screws

Chirurgie
de l'avant-pied

Brochure

–

Gamme de vis avant-pied
Vis sécables Ø 2.0 mm & vis canulées compressives Ø 2.3 / 2.9 / 4.0 mm

. Gamme **complète** & **polyvalante**
. Empreinte de vis **hexalobe**
. **Auto-perforante** & **auto-taraudante**

novastep®
Your foot & ankle company

nexis®
Cannulated Screws

Une large gamme de vis compressive, en alliage de titane, conçue avec des propriétés auto-perforantes et auto-taraudantes pour apporter une solution rapide et efficace au traitement des pathologies de l'avant pied notamment pour les traitements de l'hallux valgus, de l'hallux rigidus et des métatarsalgies.

Nexis® : La solution avant-pied



Pointe auto-perforante avec triple affutage : Mise en place rapide et simplifiée

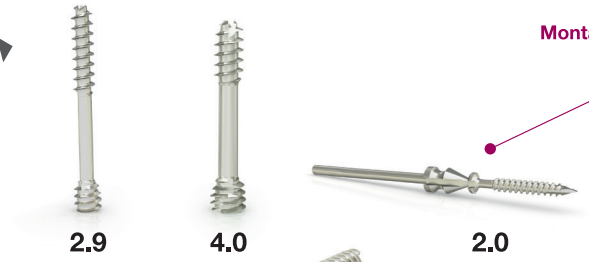

Montage sur passe-broche

Auto-taraudante : Enfouissement facilité
Rétro-taraudante : Facilité d'extraction

Tête conique ultra-pénétrante :
Implantation atraumatique

Empreinte hexalobe :
Transmission de couple optimale

Indications

Ostéotomies, arthrodèses et fractures de l'avant-pied et du médio-pied.

Exemples :
. **Ø 2.0 mm :** Ostéotomie de Weil.
. **Ø 2.3 mm et Ø 2.9 mm :** Ostéotomie de P1, Scarf et Chevron.
. **Ø 4.0 mm :** Arthrodèse MTP et Cunéo-Métatarsienne.

Matériaux :
Alliage de Titane TA6V ELI anodisé.

	Ø2 nexis®	Ø2.3 nexis®	Ø2.9 nexis®	Ø4 nexis®
Empreinte de vis	Weil	T7	T8	T10
Diamètre filetage distal	Ø 2.0 mm	Ø 2.3 mm	Ø 2.9 mm	Ø 4.0 mm
Longueur de vis	11 - 16 mm [1]	10 - 30 mm [2]	10 - 34 mm [2]	18 - 60 mm [3]
Broche de guidage	N/A	Ø 0.9 x 80 mm	Ø 1.0 x 80 mm	Ø 1.4 x 100 mm
Tournevis	N/A	Rétentif / Non rétentif [4]	Rétentif / Non rétentif [4]	Rétentif

[1] Incréments de 1 mm. / [2] Incréments de 2 mm. / [3] Incréments de 2 mm jusque 50 mm, puis incréments de 5 mm. / [4] Optionnel.

Instrumentation avant-pied dédiée et modulaire

Modularité

Un concept modulaire permettant une personnalisation de l'ancillaire en fonction des préférences du praticien ou de l'indication.
Deux versions disponibles :

. **ForefootCOMPLETE :** possibilité d'accueillir les modules vis Nexis®, agrafes Arcad® et implant intramédullaire Lync® dans une même boite.
. **ForefootEXACT :** possibilité d'interchanger les modules Nexis®, agrafes Arcad® et implant intramédullaire Lync® pour un encombrement réduit dans une demie-boite.

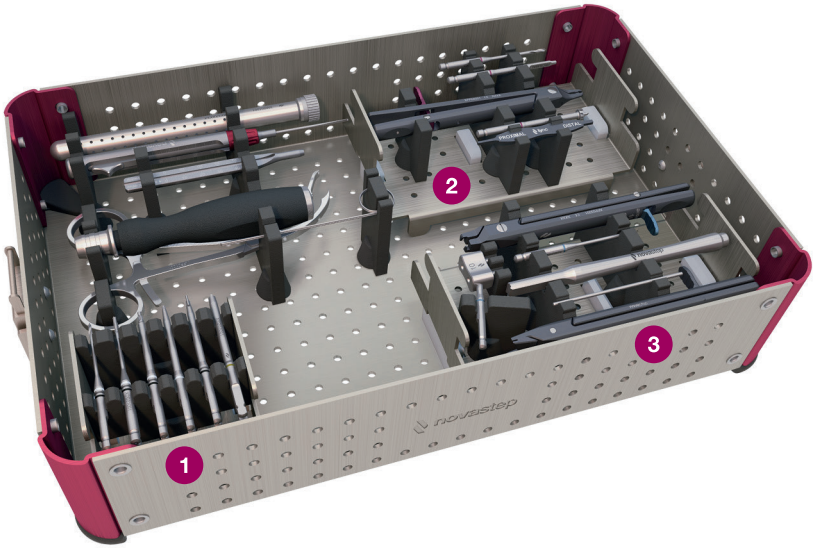

ForefootCOMPLETE

ForefootEXACT

1. **Module vis Nexis®**
2. **Module implant intramédulaire Lync®**
3. **Module agrafe Arcad®**

Instrumentation dédiée

Une instrumentation spécifique pour chaque ostéotomie : Weil, Scarf, Chevron, M1.



Tournevis à ergots pour vis sécables :
Empreinte de vis conçue avec des ergots pour une mise en place directe sur passe-broche ou au tournevis à ergots.

Elévateur pour ostéotomie de Weil
(XMS01007)*

Davier de Scarf
(XFP01001)*

Davier de Chevron
(XFP01004)*

** Optionnel*

Code couleur

Un code couleur par gamme de vis pour une identification rapide.



: Ø 2.0 mm



: Ø 2.3 mm



: Ø 2.9 mm



: Ø 4.0 mm

Références

Vis sécables

Longueur (mm)	Ø 2.0 mm
10	-
11	SC040011
12	SC040012
13	SC040013
14	SC040014
15	SC040015
16	SC040016

K-Wires

Ref	Description
33-T10-R-09-080	K-Wire Ø 0.9 Lg 80 TR/RD
33-T10-R-10-080	K-Wire Ø 1.0 Lg 80 TR/RD
33-T10-R-14-100	K-Wire Ø 1.4 Lg 100 TR/RD

Vis canulées

Longueur (mm)	Ø 2.3 mm	Ø 2.9 mm	Ø 4.0 mm
10	SC010010	SC020010	-
11	-	-	-
12	SC010012	SC020012	-
13	-	-	-
14	SC010014	SC020014	-
15	-	-	-
16	SC010016	SC020016	-
18	SC010018	SC020018	SC050018
20	SC010020	SC020020	SC050020
22	SC010022	SC020022	SC050022
24	SC010024	SC020024	SC050024
26	SC010026	SC020026	SC050026
28	SC010028	SC020028	SC050028
30	SC010030	SC020030	SC050030
32	-	SC020032	SC050032
34	-	SC020034	SC050034
36	-	-	SC050036
38	-	-	SC050038
40	-	-	SC050040
50	-	-	SC050050
55	-	-	SC050055
60	-	-	SC050060

Nexis®

Gamme médio / arrière-pied

Vis compressives canulées :
. Ø 5.0 mm
. Ø 7.0 mm
. Empreinte hexalobe

Gamme MIS

Vis compressives canulées biseautées :
. Ø 2.7 mm
. Empreinte Exact-2T spécifique & universelle

Recommandation :
Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés. Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe IIa-CE1639.

Novastep :
2, Allée Jacques Frimot - 35000 RENNES - France
Tel : + 33 (0) 2 99 33 86 50 / Fax : + 33 (0) 9 70 29 18 95
contact@novastep-ortho.com / www.novastep-ortho.com

Référence : Nex-Fore-L-Ed5-07-22-FR