

## Base/Couvercle

Réf.#	Description	Qté
<b>A</b> ACC1016P0001	Boîte	1
<b>B</b> ACC1016P0003	Couvercle	1
<b>C</b> ACC1002P0008	Plaque support pied	1

## Instrumentation Générale

Réf.#	Description	Qté
<b>D</b> XHA01001	Manche AO	1
<b>E</b> XGA01002	Jauge de profondeur	1
<b>F</b> ACC1016P0004	Support de broche	1
-	Broche Ø1.4 lg 150 - TR/RD <sup>(1)</sup>	5*
-	Broche Ø1.6 lg 180 -TR/RD <sup>(2)</sup>	5*
<b>G</b> XKW01002	Broche de nettoyage Ø1.4	1

<sup>(1)</sup>Broche Medetechnik® (33-T10-R-14-150) vendue séparément

<sup>(2)</sup>Broche Medetechnik® (33-T10-R-16-180) vendue séparément

## Instrumentation Airlock®

Réf.#	Description	Qté
<b>1</b> XSD02002	Embout AO T8	2
<b>2</b> XPP01003	Broche de positionnement sphérique	2
<b>3</b> XGA01003	Mesureur de vis	1
<b>4</b> XDG01023	Presslock® - Viseur pour vis Ø3.5	1
<b>5</b> XDG01022	Viseur Oblong pour vis Ø3	2
<b>6</b> XDG01021	Viseur verrouillé pour vis Ø3 et Ø3.5	1
<b>7</b> XDB01021	Foret Ø2	2
<b>8</b> XDB01022	Foret Ø2.5	Optionnel
<b>9</b> XMS01004	Préhenseur de viseur	1
<b>10</b> XDG01020	Viseur non-verrouillé pour vis Ø3 et Ø3.5	1

## Fraises et cambreurs de plaques

Réf.#	Description	Qté
<b>11</b> XMS01010	Cambreur de plaques	2
<b>12</b> XRE01010	Fraise convexe Ø18	1
<b>13</b> XRE01005	Fraise convexe Ø20	1
<b>14</b> XRE01006	Fraise convexe Ø22	1
<b>15</b> XRE01011	Fraise concave Ø18	1
<b>16</b> XRE01003	Fraise concave Ø20	1
<b>17</b> XRE01004	Fraise concave Ø22	1

## Instrumentation Nexis®

Réf.#	Description	Qté
<b>18</b> XSD03001	Embout de tournevis à ergot	1
<b>19</b> XSD04001	Embout AO T10	1
<b>20</b> XRE01007	Fraise à chambrer Ø3.7 - Nexis® / PECA®-C	1
<b>21</b> XDB01007	Foret canulé Ø2.7	1
<b>22</b> XDG01009	Double viseur pour vis Ø4	1
<b>23</b> XGA01009	Réglet Lg 150	1
<b>24</b> XSD05001	Embout AO T20	1
<b>25</b> XRE01008	Fraise à chambrer Ø4.9	1
<b>26</b> XDB01009	Foret canulé Ø3.2	1
<b>27</b> XDG01015	Double viseur pour vis Ø5	1







## Instrumentation optionnelle - PECA®-C

Réf.#	Description	Qté
<b>28</b> XSD04004	Embout AO Exact-T®10	1
CKW02005	Broche Ø1.4 Lg 150 TR/RD CrCo <sup>(1)</sup>	







<sup>(1)</sup>Broche vendue séparément.

## Implants d'essai






### Module Plaques d'essai Airlock<sup>®</sup> MTP

	Réf.#	Description	Qté
<b>H</b>	ACC1006P0009	Support plaques d'essai	1
-	XTI01001	 Plaque d'essai MTP Medium gauche	1
-	XTI01002	 Plaque d'essai MTP Medium droite	1
-	XTI01301	 Plaque d'essai MTP Courte gauche	1
-	XTI01302	 Plaque d'essai MTP Courte droite	1
-	XTI01401	 Plaque d'essai MTP longue gauche	1
-	XTI01402	 Plaque d'essai MTP longue droite	1









### Module Plaques d'essai Airlock<sup>®</sup> Fusion

	Réf.#	Description	Qté
<b>I</b>	ACC1006P0007	Support plaques d'essai	1
-	XTI04117	 Plaque d'essai Fusion droite courte	1
-	XTI04120	 Plaque d'essai Fusion droite medium	1
-	XTI04123	 Plaque d'essai Fusion droite longue	1
-	XTI04217	 Plaque d'essai Fusion H courte	1
-	XTI04220	 Plaque d'essai Fusion H medium	1
-	XTI04223	 Plaque d'essai Fusion H longue	1







### Module Plaques d'essai Airlock<sup>®</sup> Lisfranc

	Réf.#	Description	Qté
<b>J</b>	ACC1006P0012	Support plaques d'essai	1
-	XTI05010	 Plaque d'essai Lisfranc H courte	1
-	XTI05020	 Plaque d'essai Lisfranc H medium	1
-	XTI05030	 Plaque d'essai Lisfranc H large	1
-	XTI05040	 Plaque d'essai Lisfranc T courte	1
-	XTI05050	 Plaque d'essai Lisfranc T longue	1









### Module Plaques d'essai Airlock<sup>®</sup> Lapidus

	Réf.#	Description	Qté
<b>K</b>	ACC1006P0011	Support plaques d'essai	1
-	XTI03301	 Plaque d'essai Lapidus courte droite	1
-	XTI03302	 Plaque d'essai Lapidus courte gauche	1
-	XTI03401	 Plaque d'essai Lapidus longue droite	1
-	XTI03402	 Plaque d'essai Lapidus longue gauche	1
-	XTI08101	 Plaque d'essai Lapidus plantaire courte droite	1
-	XTI08102	 Plaque d'essai Lapidus plantaire courte gauche	1
-	XTI08201	 Plaque d'essai Lapidus plantaire longue droite	1
-	XTI08202	 Plaque d'essai Lapidus plantaire longue gauche	1


### Module Plaques d'essai Airlock<sup>®</sup> Utility

	Réf.#	Description	Qté
<b>L</b>	ACC1006P0010	Support plaques d'essai	1
-	XTI04016	 Plaque d'essai Utility 2 trous	1
-	XTI04022	 Plaque d'essai Utility 3 trous	1
-	XTI04028	 Plaque d'essai Utility 4 trous	1
-	XTI04034	 Plaque d'essai Utility 5 trous	1
-	XTI04040	 Plaque d'essai Utility 6 trous	1
-	XTI04046	 Plaque d'essai Utility 7 trous	1


### Module Plaques d'essai Airlock<sup>®</sup> Ostéotomie basale // OPTION

	Réf.#	Description	Qté
<b>M</b>	ACC1006P0008	Support plaques d'essai	1
-	XTI02010	 Plaque d'essai MT Closing wedge gauche	1
-	XTI02013	 Plaque d'essai MT Opening wedge 3 gauche	1
-	XTI02014	 Plaque d'essai MT Opening wedge 4 gauche	1
-	XTI02015	 Plaque d'essai MT Opening wedge 5 gauche	1
-	XTI02020	 Plaque d'essai MT Closing wedge droite	1
-	XTI02023	 Plaque d'essai MT Opening wedge 3 droite	1
-	XTI02024	 Plaque d'essai MT Opening wedge 4 droite	1
-	XTI02025	 Plaque d'essai MT Opening wedge 5 droite	1



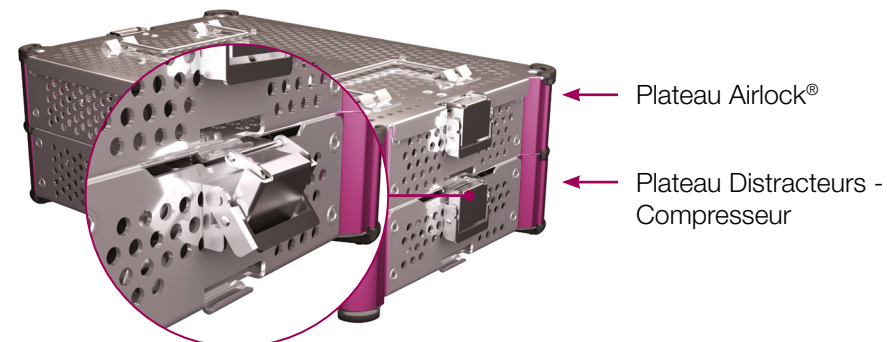

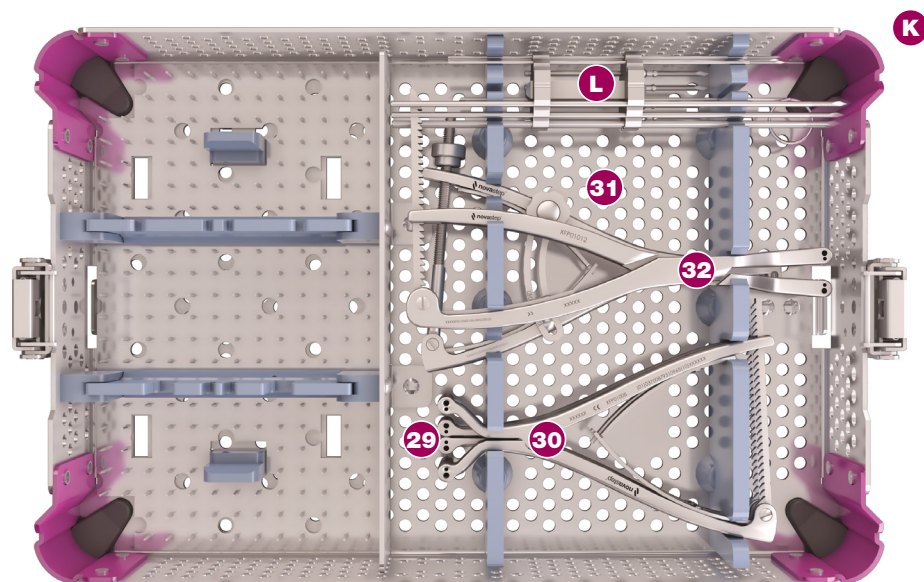


Optionnel, le plateau Distracteurs – Compresseur peut venir compléter la plateforme Airlock®. Utilisables ensemble ou séparément grâce au système d'accroche, ces deux étages permettent une approche complète et une adaptation aux différentes indications du pied.



Système d'accroche



### □ Plateau Distracteurs-Compresseur

	Réf. #	Description	Qté
<b>K</b>	ACC1016P0002	Boite distracteur	1
<b>L</b>	ACC1016P0005	Support de broches distracteur	1
-	SKW04001 <sup>(1)</sup>	 Broche filetée Ø2.5 - distracteur Opening Wedge - stérile	4
-	SKW05003 <sup>(1)</sup>	 Broche filetée TR-RD Ø1.6 lg 150 - stérile	5
-	SKW05004 <sup>(1)</sup>	 Broche filetée TR-RD Ø2.5 lg 200 - stérile	5
<b>29</b>	XFP01006	 Distracteur bras fermés	1
<b>30</b>	XFP01008	 Distracteur bras ouverts	1
<b>31</b>	XFP01011	 Distracteur Opening Wedge	1
<b>32</b>	XFP01012	 Pince compressive	1

<sup>(1)</sup>Broche filetée vendue séparément.