
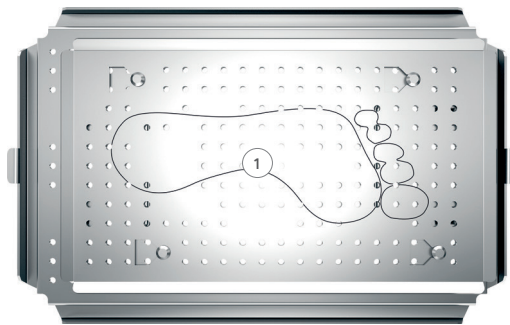


# AIRLOCK® FOOT TRAY OVERHEAD GUIDE

enovis™

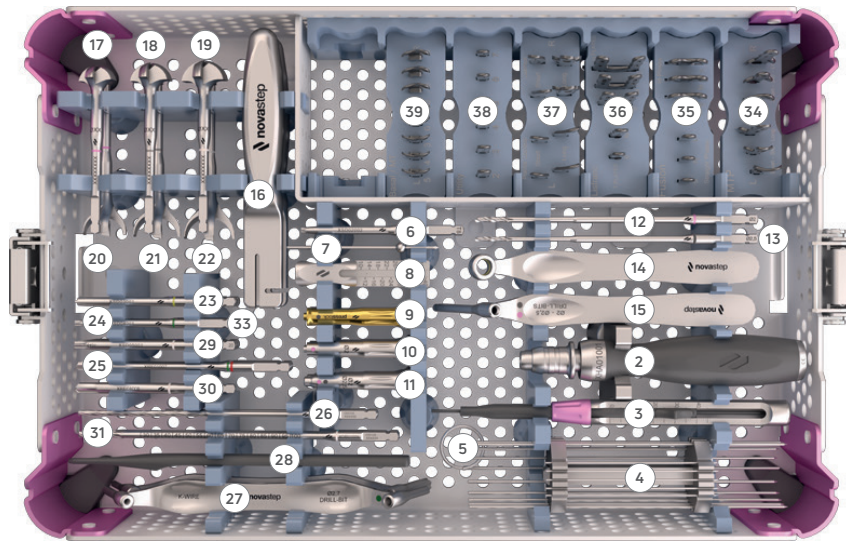

## INSTRUMENTS UNIVERSELS

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	BOITE	ACC1016P0001	1
-	COUVERCLE	ACC1016P0003	1
1	PLAQUE SUPPORT PIED	ACC1002P0008	1
2	MANCHE AO	XHA01001	1
3	JAUGE DE PROFONDEUR	XGA01002	1
4	SUPPORT DE BROCHE	ACC1016P0004	1
-	BROCHE Ø1,4 LG 150 TR/RD(1)	-	5
-	BROCHE Ø1,6 LG 180 TR/RD(2)	-	5
5	BROCHE DE NETTOYAGE Ø1,4	XKW01002	1

<sup>(1)</sup> Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-14-150) ou broche Novastep® (CKW01010) sont disponibles en fonction de votre marché.

<sup>(2)</sup> Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-16-180) ou broche Novastep® (CKW01004) sont disponibles en fonction de votre marché.

## INSTRUMENTATION AIRLOCK®

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
6	EMBOUT AO T8	XSD02002	2
7	BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE	XPP01003	2
8	MESUREUR DE VIS	XGA01003	1
9	PRESSLOCK® - VISEUR POUR VIS Ø 3.5	XDG01023	1
10	VISEUR OBLONG POUR VIS Ø3	XDG01022	2
11	VISEUR VERROUILLÉ POUR VIS Ø3 ET Ø3.5	XDG01021	1
12	FORET Ø2	XDB01021	2
13	FORET Ø2.5	XDB01022	OPTION
14	PRÉHENSEUR DE VISEUR	XMS01004	1
15	VISEUR NON VERROUILLÉ POUR VIS Ø3 ET Ø3.5	XDG01020	1

## FRAISES & CAMBREUR DE PLAQUES

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
16	CAMBREUR DE PLAQUE	XMS01010	2
17	FRAISE CONVEXE Ø18	XRE01010	1
18	FRAISE CONVEXE Ø20	XRE01005	1
19	FRAISE CONVEXE Ø22	XRE01006	1
20	FRAISE CONCAVE Ø18	XRE01011	1
21	FRAISE CONCAVE Ø20	XRE01003	1
22	FRAISE CONCAVE Ø22	XRE01004	1

## INSTRUMENTATION NEXIS®

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
23	EMBOUT DE TOURNEVIS À ERGOT	XSD03001	1
24	EMBOUT AO T10	XSD04001	1
25	FRAISE À CHAMBRER	XRE01007	1
26	FORET CANULÉ Ø2.7	XDB01007	1
27	DOUBLE VISEUR POUR VIS Ø4	XDG01009	1
28	RÉGLET LG 150	XGA01009	1
29	EMBOUT AO T20	XSD05001	OPTION
30	FRAISE À CHAMBRER Ø4.9	XRE01008	OPTION
31	FORET CANULÉ Ø3.2	XBD01009	OPTION
32	DOUBLE VISEUR POUR VIS Ø5	XDG01015	OPTION

## INSTRUMENTATION PECA®-C

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
33	EMBOUT AO EXACT2-T15	XSD09002	OPTION
-	FORET AO Ø3.2	XDB01030	OPTION
-	BROCHE Ø1,6 LG 150 TR/RD <sup>(3)</sup>	-	OPTION

<sup>(3)</sup> Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-16-150) ou broche Novastep® (CKW01003) disponible en fonction de votre marché.

## PLAQUES D'ESSAI MTP

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
34	SUPPORT PLAQUES D'ESSAI	ACC1006P0009	1
-	PLAQUE D'ESSAI MTP MEDIUM GAUCHE	XTI01001	1
-	PLAQUE D'ESSAI MTP MEDIUM DROITE	XTI01002	1
-	PLAQUE D'ESSAI MTP COURTE GAUCHE	XTI01301	1
-	PLAQUE D'ESSAI MTP COURTE DROITE	XTI01302	1
-	PLAQUE D'ESSAI MTP LONGUE GAUCHE	XTI01401	1
-	PLAQUE D'ESSAI MTP LONGUE DROITE	XTI01402	1

## PLAQUES D'ESSAI FUSION

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
35	SUPPORT PLAQUES D'ESSAI	ACC1006P0007	1
-	PLAQUE D'ESSAI FUSION DROITE COURTE	XTI04117	1
-	PLAQUE D'ESSAI FUSION DROITE MEDIUM	XTI04120	1
-	PLAQUE D'ESSAI FUSION DROITE LONGUE	XTI04123	1
-	PLAQUE D'ESSAI FUSION H COURTE	XTI04217	1
-	PLAQUE D'ESSAI FUSION H MEDIUM	XTI04220	1
-	PLAQUE D'ESSAI FUSION H LONGUE	XTI04223	1

### PLAQUES D'ESSAI LISFRANC

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
36	SUPPORT PLAQUES D'ESSAI	ACC1006P0012	1
-	PLAQUE D'ESSAI LISFRANC H COURTE	XTI05010	1
-	PLAQUE D'ESSAI LISFRANC H MEDIUM	XTI05020	1
-	PLAQUE D'ESSAI LISFRANC H LARGE	XTI05030	1
-	PLAQUE D'ESSAI LISFRANC T COURTE	XTI05040	1
-	PLAQUE D'ESSAI LISFRANC T LONGUE	XTI05050	1

### PLAQUES D'ESSAI UTILITY


#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
38	SUPPORT PLAQUES D'ESSAI	ACC1006P0010	1
-	PLAQUE D'ESSAI UTILITY 2 TROUS	XTI04016	1
-	PLAQUE D'ESSAI UTILITY 3 TROUS	XTI04022	1
-	PLAQUE D'ESSAI UTILITY 4 TROUS	XTI04028	1
-	PLAQUE D'ESSAI UTILITY 5 TROUS	XTI04034	1
-	PLAQUE D'ESSAI UTILITY 6 TROUS	XTI04040	1
-	PLAQUE D'ESSAI UTILITY 7 TROUS	XTI04046	1

### PLAQUES D'ESSAI LAPIDUS

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
37	SUPPORT PLAQUES D'ESSAI	ACC1006P0011	1
-	PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS COURTE DROITE	XTI03301	1
-	PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS COURTE GAUCHE	XTI03302	1
-	PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS LONGUE DROITE	XTI03401	1
-	PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS LONGUE GAUCHE	XTI03402	1
-	PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS PLANTAIRE COURTE DROITE	XTI08101	1
-	PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS PLANTAIRE COURTE GAUCHE	XTI08102	1
-	PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS PLANTAIRE LONGUE DROITE	XTI08201	1
-	PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS PLANTAIRE LONGUE GAUCHE	XTI08202	1

### PLAQUES D'ESSAI OSTÉOTOMIE BASALE - OPTION

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
39	SUPPORT PLAQUES D'ESSAI	ACC1006P0008	1
-	PLAQUE D'ESSAI MT CLOSING WEDGE GAUCHE	XTI02010	1
-	PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 3 GAUCHE	XTI02013	1
-	PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 4 GAUCHE	XTI02014	1
-	PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 5 GAUCHE	XTI02015	1
-	PLAQUE D'ESSAI MT CLOSING WEDGE DROITE	XTI02020	1
-	PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 3 DROITE	XTI02023	1
-	PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 4 DROITE	XTI02024	1
-	PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 5 DROITE	XTI02025	1

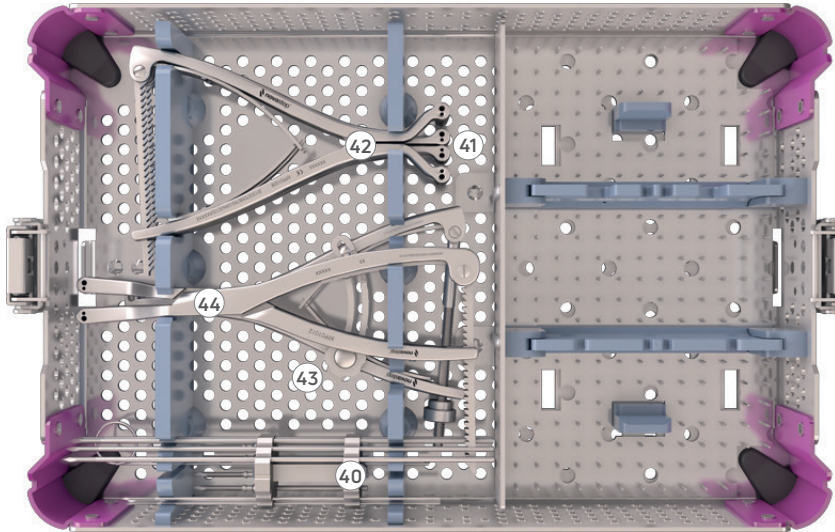

### BOITE DISTRACTEUR & COMPRESSEUR - OPTION

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	BOITE DISTRACTEUR	ACC1016P0002	1
40	SUPPORT DE BROCHE DISTRACTEUR	ACC1016P0005	1
-	BROCHE FILETÉE Ø2,5 - DISTRACTEUR OPENING WEDGE - STÉRILE <sup>(1)</sup>	SKW04001	4
-	BROCHE FILETÉE Ø1,6 LG 140 TR/RD - STÉRILE <sup>(1)</sup>	SKW05003	5
-	BROCHE FILETÉE Ø2,5 LG 140 TR/RD - STÉRILE <sup>(1)</sup>	SKW05004	5
41	DISTRACTEUR BRAS FERMÉS	XFP01006	1
42	DISTRACTEUR BRAS OUVERTS	XFP01008	1
43	DISTRACTEUR OPENING WEDGE	XFP01011	1
44	PINCE COMPRESSIVE	XFP01012	1

<sup>(1)</sup>Broche filetée vendue séparément

**enovis**

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F + 33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant : Novastep® S.A.S  
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France  
contact-intfa@enovis.com  
www.int.novastep.life  
Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.  
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

RÉFÉRENCE: AIR-TL02-ED4-02-26-FR