


AIRLOCK® ANKLE TRAY OVERHEAD GUIDE

enovis™

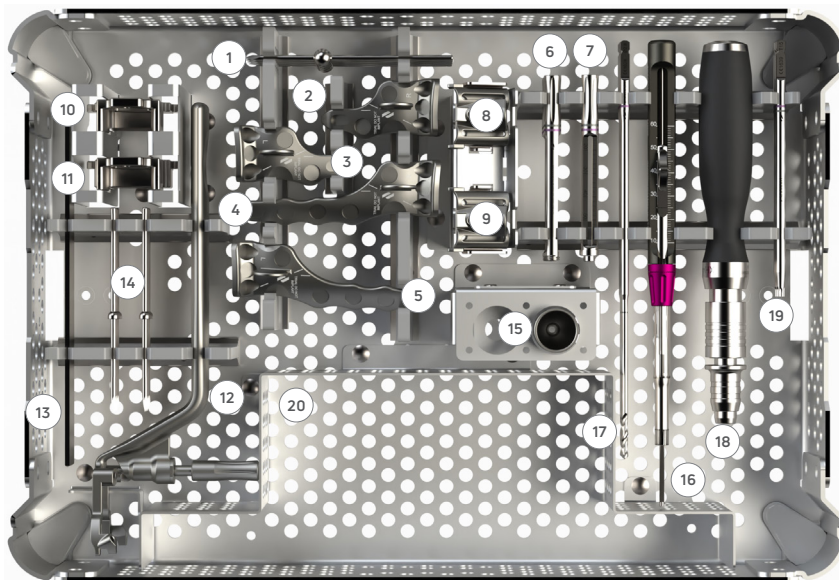

INSTRUMENTATION AIRLOCK® ANKLE

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	BOITE	ACC1021P0001	1
-	COUVERCLE	ACC1021P0002	1
1	BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE	XPP01006	4
2	PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MINI DROITE	XTI09110	1
3	PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MINI GAUCHE	XT09210	1
4	PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MEDIUM DROITE	XTI09140	1
5	PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MEDIUM GAUCHE	XTI09240	1
6	WISEUR VERROUILLÉ POUR VIS Ø 4 ET Ø 4.7	XDG01025	3
7	WISEUR OBLONG POUR VIS Ø 4 ET Ø 4.7	XDG01026	1

enovis™

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F +33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant: Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
8	BLOC QUICK-DRILL - DROIT	XMS01047-1	1
9	BLOC QUICK-DRILL - GAUCHE	XMS01047-2	1
10	FENÊTRE DE CENTRAGE	XMS01043	1
11	FENÊTRE DE COUPE TIBIO-TALIEENNE	XMS01044-3	1
12	CHÂSSIS GUIDE DE COUPE	XMS01042	1
13	DISPOSITIF DE CENTRAGE	XMS01045	1
14	BROCHE DE POSITIONNEMENT - GUIDE DE COUPE - STÉRILE	SKW09001	6
15	WISEUR POLYAXIAL POUR VIS Ø 4	XDG01032	1
16	JAUGE DE PROFONDEUR	XGA01012	1
17	FORET Ø 2.8	XDB01026	3
18	MANCHE AO	XHA01002	1
19	EMBOUT AO T15	XSD08001	2

INSTRUMENTATION NEXIS® Ø7 - OPTION

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
20	EMBOUT AO LARGE PLEIN T25	XSD06003	1
20	FORET CANULÉ Ø 4.8	XDB01010	1
20	FRAISE À CHAMBRER Ø 6	XRE01009	1
20	MANCHE AO LARGE DROIT	XHA01003	1
20	RÉGLET LG 180/200	XGA01007	1
20	BROCHE Ø 2.2 LG 200 TR/RD ⁽¹⁾	-	5

⁽¹⁾ Broche vendue séparément - Broche Mediatechnik® (33-T10-R-22-200) ou broche Novastep® (CKW01011) disponibles en fonction de votre marché.

LAME DE SCIE

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	LAME DE SCIE STÉRILE 100 x 17 x 1,27 CONNECTIQUE STRYKER	71.34.0751 ⁽¹⁾	1
-	LAME DE SCIE STÉRILE 100 x 17 x 1,27 CONNECTEUR SYNTHES	71.34.0095 ⁽¹⁾	1

⁽¹⁾Vendue séparément

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

RÉFÉRENCE: AIR-ANK-TL-ED0-05-25-FR